

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2026-03-01 00:00 ~ 2026-03-31 23:59

最大值: 71.8 %RH

最小值: 36.1 %RH

平均值: 54.0 %RH

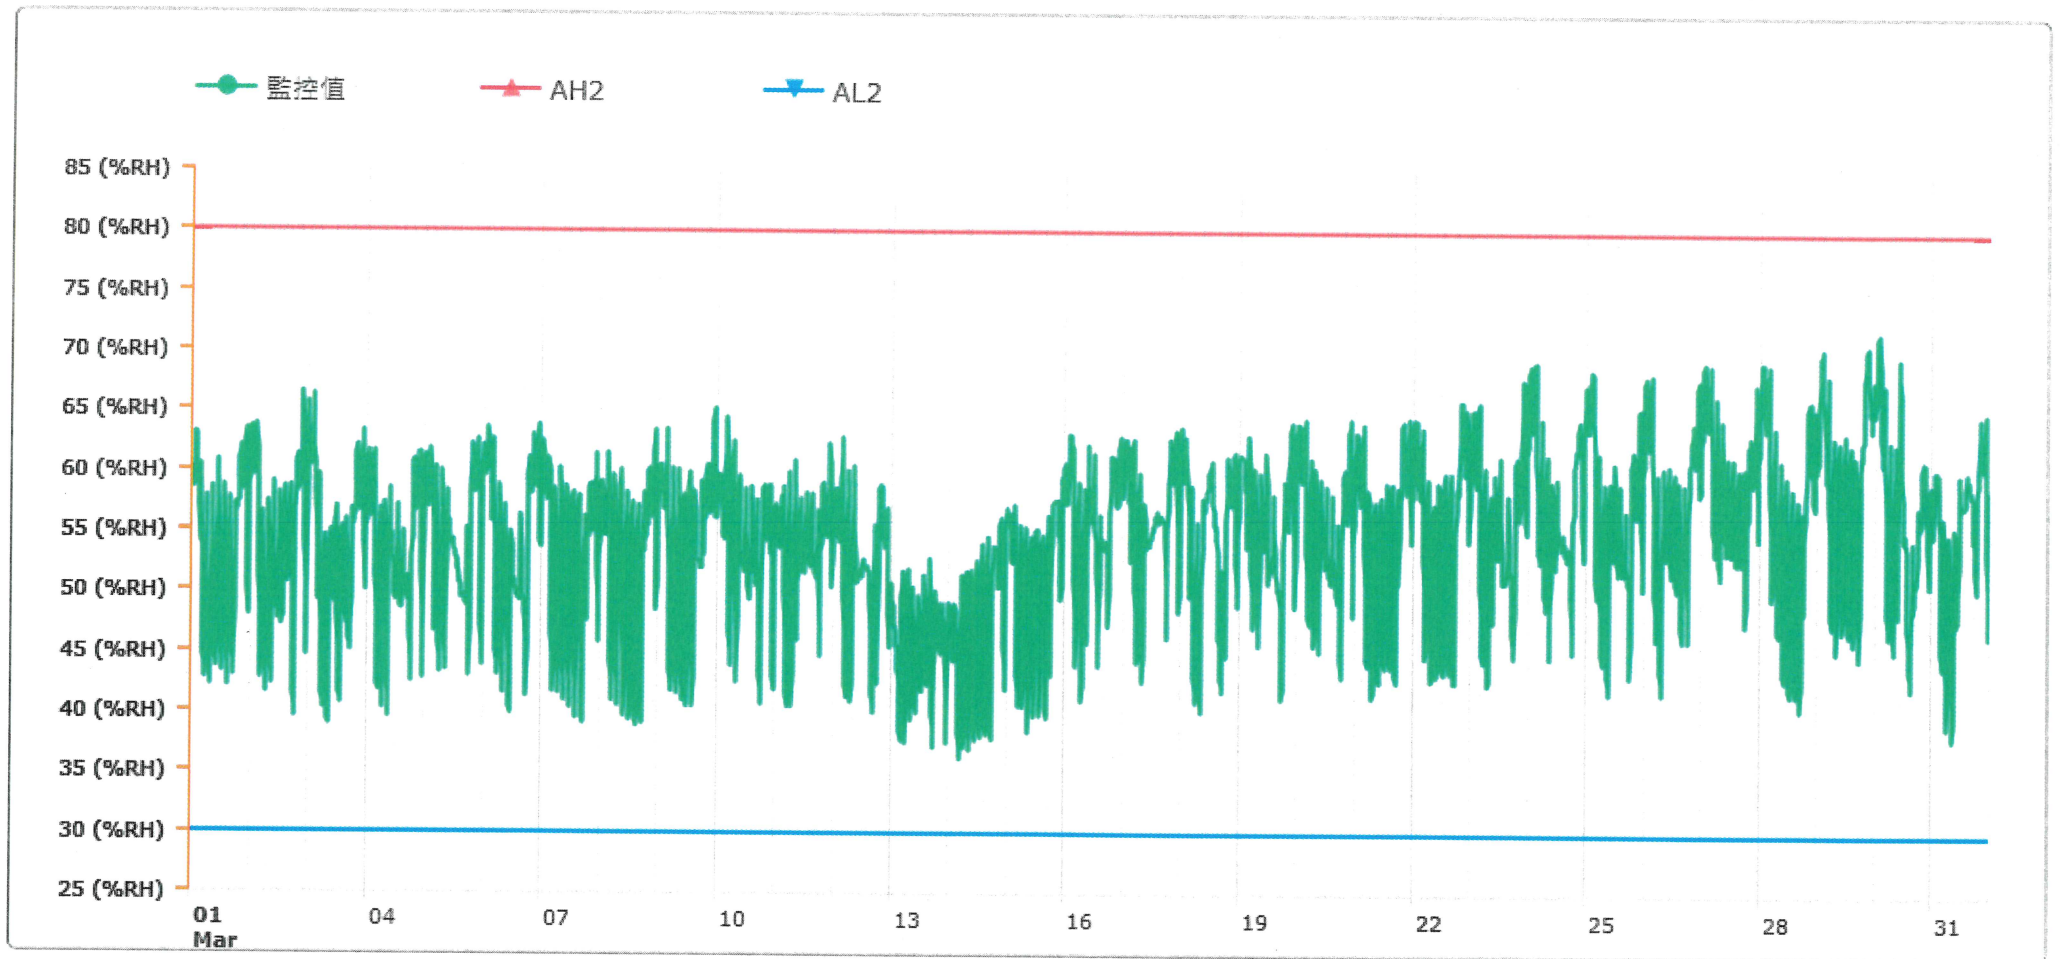

製表者: 丁鈺龍 Yu-long Ding 03 Apr 2026

單位主管: Sin-Y. Huang 03 Apr 2026