

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2026-04-01 00:00 ~ 2026-04-30 23:59

最大值: 66.4 %RH

最小值: 35.2 %RH

平均值: 50.9 %RH

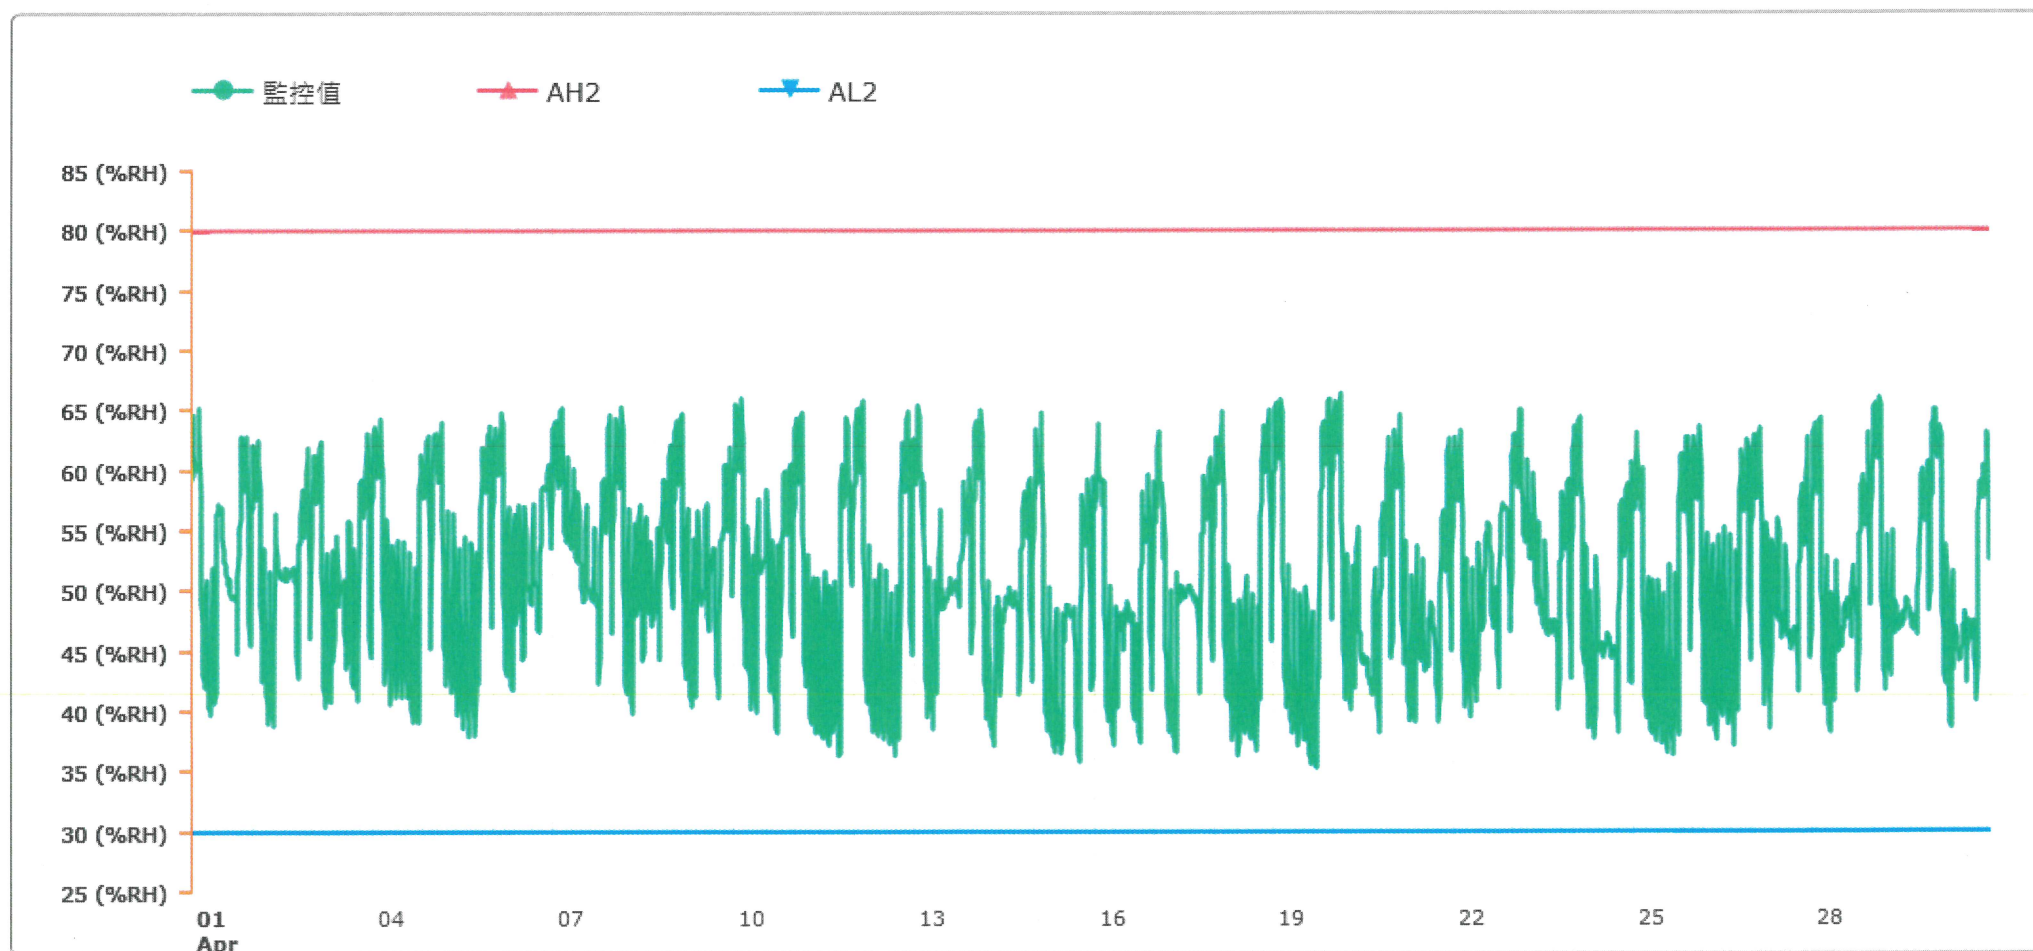

製表者: 丁鈺龍 Yu-Long Ding 04 May 2026

單位主管: Sin-yi Huang 05 May 2026