

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局環境濕度

時間區間: 2026-05-01 00:00 ~ 2026-05-31 23:59

最大值: 67.5 %RH

最小值: 31.3 %RH

平均值: 47.8 %RH

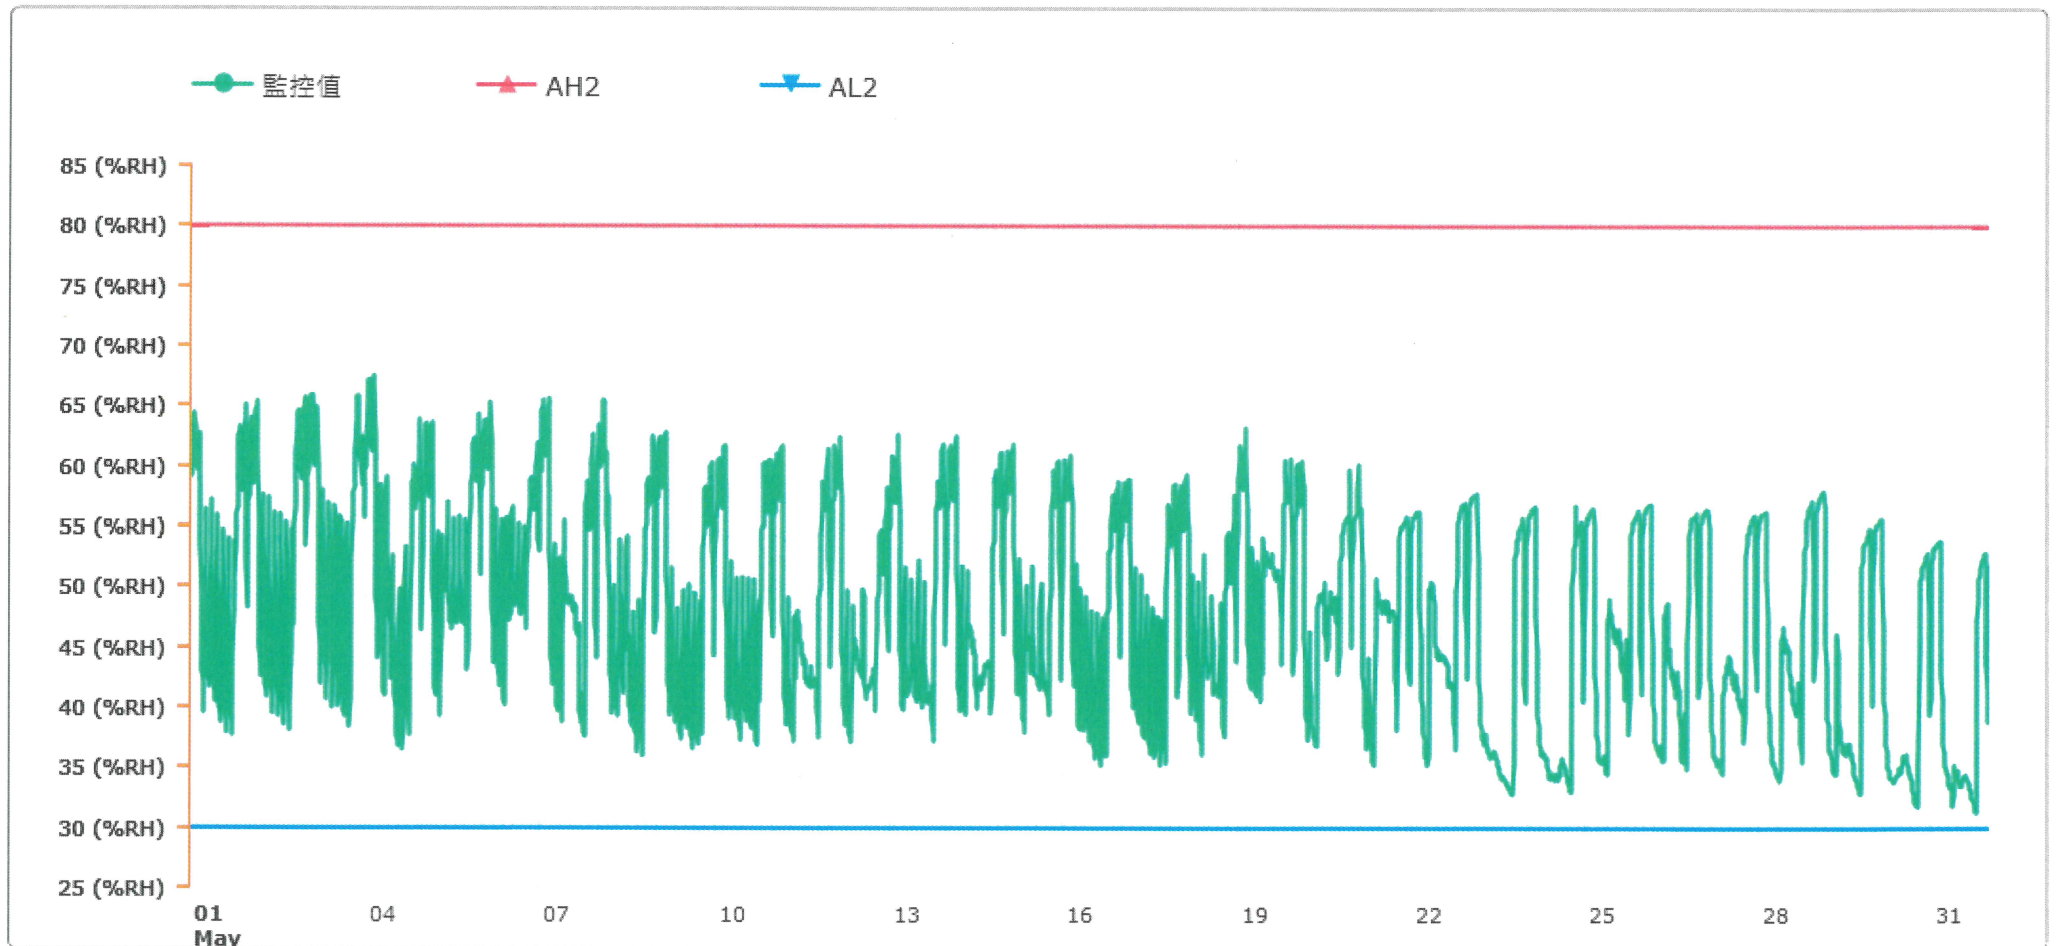

製表者: 丁鈺龍 Yu-Long Ding 01 Jun 2026

單位主管: Sin-Yi Huang 01 Jun 2026